Audio Service

Sisteme auditive BTE

HP Li-Ion G6

Nivel tehnic	16	12	8	6	4	melodii		



Baterie: Baterie litiu-ion

Amplificare: 82 dB (cu cârlig de ureche)

Fișa tehnică este valabilă și pentru bateria T2.0 HP Li-Ion G6


HP Li-Ion G6 | Date tehnice

Tip		Cârlig pentru ureche	
		Cuplaj de 2 cm³	Simulator de urechi
Nivelul presiunii sonore la ieșire			
OSPL90 la 1,6 kHz		-	135 dB SPL
OSPL90 maxim		140 dB SPL	144 dB SPL
HFA OSPL90		133 dB SPL	-
Câștig maxim			
FOG la 1,6 kHz		-	77 dB
FOG maxim		82 dB	86 dB
HFA FOG		74 dB	-
Câștig de test de referință		56 dB	60 dB
Frecvență, zgomot și directivitate			
Interval de frecvență	TL 16	100 - 5400 Hz	100 - 5400 Hz
	TL 12, 8, 6, 4	100 - 5400 Hz	100 - 5400 Hz
Zgomot de intrare echivalent		18 dB SPL	18 dB SPL
Distorsiune armonică totală la 500 / 800 / 1600 / 3200 Hz		5 / 1 / 1 / 1 %	5 / 2 / 2 / – %
Zgomot de tinitus în bandă largă		94 dB SPL	-
AI-DI		3,8 dB	
Latență		< 15 ms	
Sensibilitatea bobinei inductive			
MASL (1 mA/m) la 1,6 kHz		-	108 dB SPL
HFA-SPLIV complet (10mA/m)		124 dB SPL	-
DIVIZIONĂRI HFA (stânga/dreapta)		116 / 116 dB SPL	-
RSET-uri (stânga/dreapta)		0 / 0 dB	-
HFA SPLIV		116 dB SPL	-
Baterie			
Durata de funcționare a bateriei (fără streaming)		până la 61 de ore	
Durată de funcționare a bateriei (inclusiv 5 ore de streaming)		până la 57 de ore	
Compatibilitate cu telefoanele mobile			
Mod microfon		0,65 – 0,96 GHz 1,4 – 2,7 GHz	
Mod telebobină		—	


- nu se aplică

Consultați secțiunea „Informații suplimentare” pentru informații suplimentare despre valori.

HP Li-Ion G6 | Gamă de compatibilitate

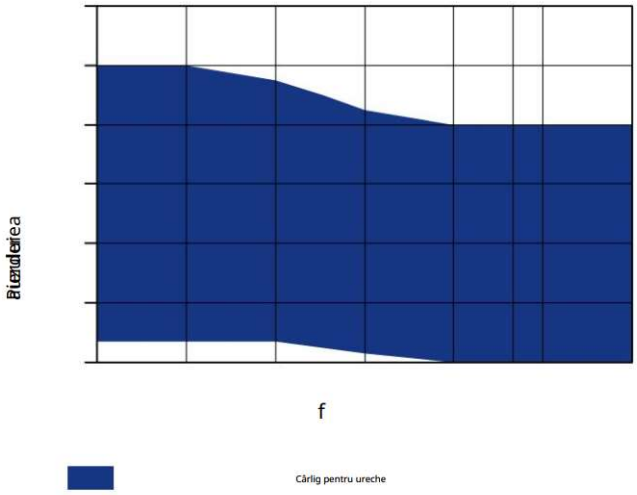


Cuplaj de 2 cm³

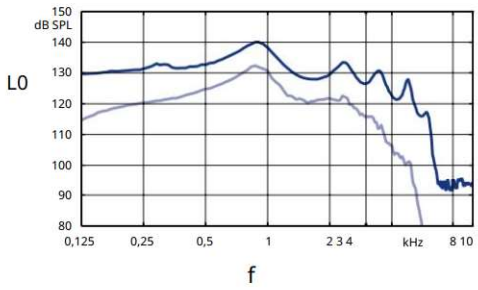


Nivel maxim de presiune sonoră la ieșire
(LI = 90 dB)

Câștig maxim
(LI = 50 dB)

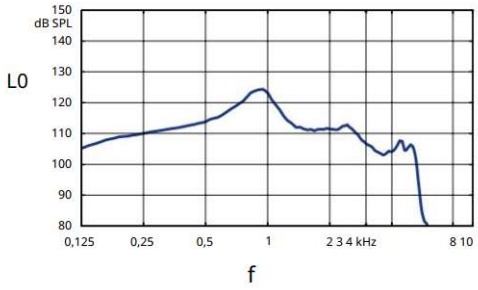


Răspuns în frecvență
(LI = 60 dB)

Simulator de urechi

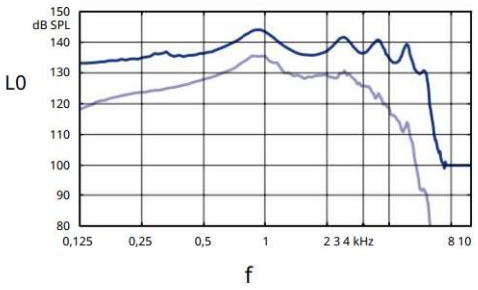


Nivel maxim de presiune sonoră la ieșire
(LI = 90 dB)

Câștig maxim
(LI = 50 dB)

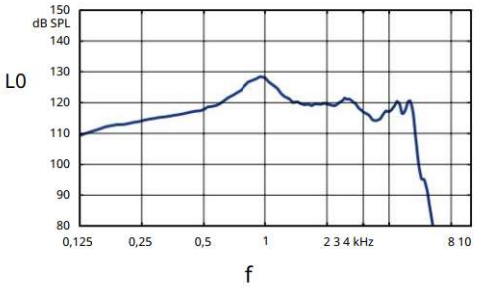


Acustică de bază
răspuns
(LI = 60 dB)


Răspuns inductiv

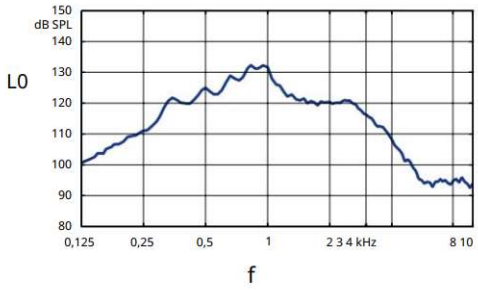

Inductiv
răspuns
(H = 10 mA/m)

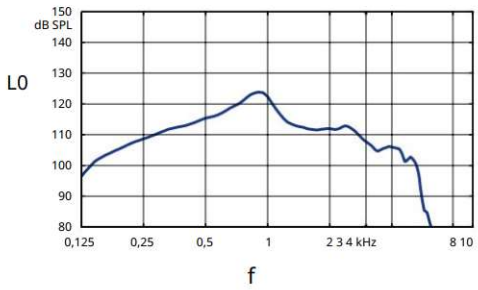

Curba SPLIV
(H = 31,6 mA/m)

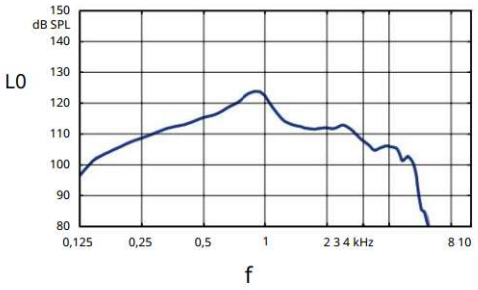

Curba SPLITS
stânga (H
= 31,6 mA/m)

Curbă SPLITS

dreapta (H = 31,6 mA/m)

HP Li-Ion G6 | Caracteristici și accesorii

	TL 16	TL 12	TL 8	TL 6	TL 4
Caracteristici					
Canale / Comenzi / Programe	34 / 16 / 6	32 / 16 / 6	24/12/6	16 / 8 / 4	16 / 8 / 4
Prima potrivire 48 de canale					
Senzor de mișcare integrat				—	—
Conformatic	HiRes	HiRes	HiRes	HiRes	HiRes
Oclumatic				—	—
Streaming audio direct / Volum automat	Făcut pentru iPhone, Android prin Smart Mic / Volum automat	Făcut pentru iPhone, Android prin Smart Mic / Volum automat	Făcut pentru iPhone, Android prin Smart Mic / Volum automat	Făcut pentru iPhone, Android prin Smart Mic / Volum automat	Făcut pentru iPhone, Android prin Smart Mic / Volum automat
Sincronizare binaurală					
Direcționalitate	Automat/ Adaptiv, Panoramă, Față/Spate, Stânga/Dreapta, Avansat Îngust	Automat/ Adaptiv, Panoramă, Față/Spate, Avansat Îngust	Automat/ Adaptiv, Panoramă, Avansat Îngust	Automat/ Adaptiv, Panoramă	Automat/ Adaptiv, Panoramă
Reducerea zgomotului	Zgomot Management, Impuls supresor, Direcțional	Zgomot Management, Impuls supresor, Direcțional	Zgomot Management, Impuls supresor	Zgomot Management, Impuls supresor	Zgomot Management
Reducerea zgomotului vântului	Stereofonic	Stereofonic	Standard	Standard	—
EchoClear / Dereverberație		—	—	—	—
Funcționalitate HiFi / Compresie selectivă a frecvenței	/	— /	— /	— /	— /
Muzică	Trăi, Muzicieni, Purtători de sunet	Trăi, Muzicieni, Purtători de sunet	MusicSelect	MusicSelect	Standard
Tinitus	Terapie prin sunet	Terapie prin sunet	Terapie prin sunet	Terapie prin sunet	—
2earPhone				—	—
Aclimatic / Înregistrare date	Inteligent /	Inteligent /	/	/	/
Bobină în formă de T					
Cârlig mic pentru ureche					
Grad de protecție la pătrundere	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Accesorii					
Stație de încărcare+ B-HP / Stație de încărcare B-HP / Încărcător universal prin cablu	Obligatoriu	Obligatoriu	Obligatoriu	Obligatoriu	Obligatoriu
Cheie inteligentă					
Transmițător inteligent 2,4					
Microfon inteligent					
Aplicație de servicii audio					
CROS RIC G6				—	—
CROS RIC Li-Ion G6				—	—
CROS quiX G6	—	—	—	—	—

disponibil — indisponibil opțional

HP Li-Ion G6 | Informații suplimentare

Abrevieri

Următoarele abrevieri sunt utilizate în această fișă tehnică:

SPL Nivelul presiunii sonore

Nivelul presiunii sonore la ieșire OSPL

HFA Media de înaltă frecvență

CEA Ă Câștig maxim

Nivelul de sensibilitate magnetoacustică MASL

Cuplaj SPLITS SPL pentru un simulator de telefon inductiv

Sensibilitate telefonică echivalentă simulată relativă RSETS

SPLIV SPL într-un câmp magnetic vertical

AI-DI Indicele de articulație - Indicele de directivitate

IRIL Nivelul de interferență legat de intrare

RTF Frecvența testului de referință

Streaming audio ASHA pentru aparate auditive

Standarde și informații suplimentare

- Toate măsurătorile cu cuplorul de 2 ccm au fost efectuate conform EN IEC 60118-0:2024 și ANSI S3.22:2014 dacă aplicabil.
- Toate măsurătorile cu un simulator de ureche au fost efectuate conform standardului EN 60118-0:1993 + A1:1994 și DIN 45605 (interval de frecvență), dacă este cazul.
- Toate măsurătorile de compatibilitate cu telefoanele mobile au fost efectuate conform standardelor EN IEC 60118-13:2020 și ANSI C63.19:2019.
- Definiția compatibilității cu telefoanele mobile: Se așteaptă ca utilizatorul de aparat auditiv să poată utiliza eficient un dispozitiv wireless compatibil ținute în poziție de vorbire la ureche. Interval maxim de compatibilitate cu telefoanele mobile: 0,65 – 0,96 GHz și 1,4 – 2,7 GHz.
- Curbele și figurile care reprezintă FOG sunt măsurate cu o reducere de 20 dB și un nivel de intrare SPL de 70 dB.
- Cifrele care reprezintă Zgomotul de Intrare Echivalent includ o expansiune moderată.
- Condiții de măsurare a zgomotului de tinitus: toate cursoarele pentru tinitus cu frecvență unică în poziția maximă, cursorul principal pentru volum în poziția implicită (0 dB) și controlul local al volumului în poziția implicită.
- Valorile de sensibilitate ale bobinei inductive, curbele de răspuns inductiv și valorile T se aplică numai instrumentelor cu telebobină.
- Consumul de curent este măsurat în setările de testare de referință (RTS) conform standardelor aplicabile. Datorită comportamentul de stabilizare al aparatelor auditive care acceptă RF (radiofrecvență), curentul bateriei este măsurat la 3 minute după pornire (notă: nu există asociere).
- Durata de funcționare a bateriei se bazează pe setările inițiale de ajustare, utilizând 60% din intervalul de ajustare și un test ISTS (Testul Internațional de Vorbire) Semnal de intrare Bluetooth) la 65 dB SPL (notă: asociere stabilită). Durata reală de funcționare a bateriei este determinată de calitatea bateriei, pierderea auzului, mediul sonor, utilizare și setul de funcții activate. În ceea ce privește utilizarea RF, se ia în considerare redarea audio Bluetooth de la telefon la aparatul auditiv și de la aparatul auditiv la telefon.
- Lățime de bandă extinsă de până la 10 kHz numai pentru dispozitivele TL 16.
- Au fost utilizate următoarele conexiuni acustice / căști:
  - Cârlig pentru ureche

Notă specială pentru instrumentele cu baterie reîncărcabilă litiu-ion încorporată

Durata de funcționare a tuturor bateriilor reîncărcabile litiu-ion se reduce în timp. Estimările se bazează pe capacitatea bateriilor reîncărcabile litiu-ion noi. În condiții normale de funcționare, bateria va păstra până la 80% din capacitatea inițială după 2 ani de utilizare. Vă rugăm să rețineți că performanța bateriei va varia în funcție de modelele individuale de utilizare și de condițiile de mediu.